



RAPPORT DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

CORROSION

NORMAL

CONTAMINANTS

NORMAL

ÉTAT DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT

NORMAL

Secteur

MICHAUDVILLE

Identité de la machine

1220

Composant

Liquide de refroidissement

Fluid

EXTENDED LIFE COOLANT (--- GAL)

RECOMMENDATION

The fluid is suitable for further service. Resample at the next service interval to monitor.

Table with 7 columns: Test, UOM, Method, Limit/Abn, Current, History1, History2. Rows include Numéro d'échant., Date d'échant., Âge d la Machine, Âge de l'huile, Huile changée, and Statut de l'échant.

CORROSION

All metal levels are normal indicating no corrosion in the cooling system.

Table with 7 columns: Test, UOM, Method, Limit/Abn, Current, History1, History2. Rows include Fer, Aluminium, Cuivre, Plomb, Étain, Argent, and Zinc.

CONTAMINANTS









There is no indication of any contamination in the coolant.

Table with 7 columns: Test, UOM, Method, Limit/Abn, Current, History1, History2. Rows include Calcium, Magnésium, Apparence, Odeur, and Apparence du liquide de refroidissement.

ÉTAT DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT

The nitrite level is acceptable. The pH level of this fluid is within the acceptable limits. The reserve alkalinity of this fluid is acceptable.

Table with 7 columns: Test, UOM, Method, Limit/Abn, Current, History1, History2. Rows include Densité, pH, Nitrites, Réserve d'alcalinité, Pourcentage de glycol, Point de congélation, Carboxylate, Silicium, Phosphore, Bore, Molybdène, Sodium, Potassium, and Couleur du liquide de refroidissement.

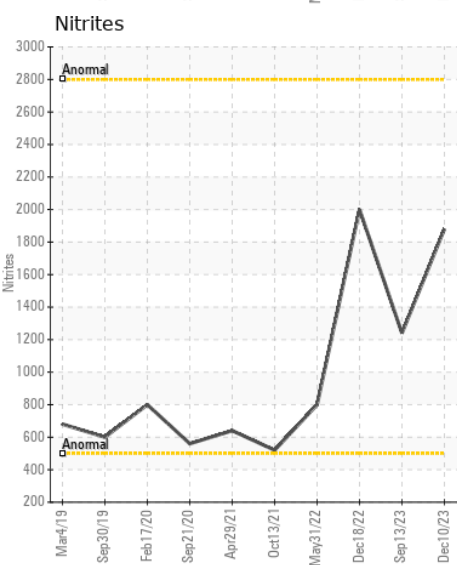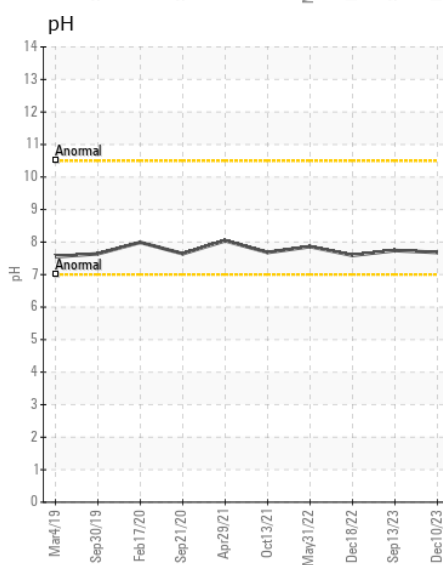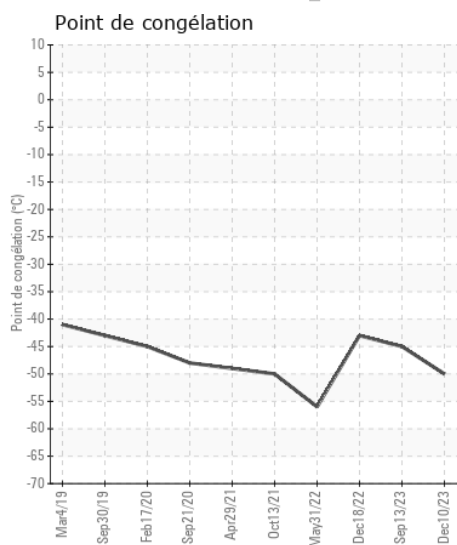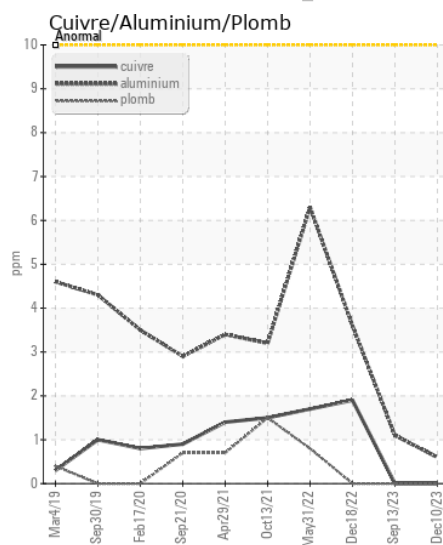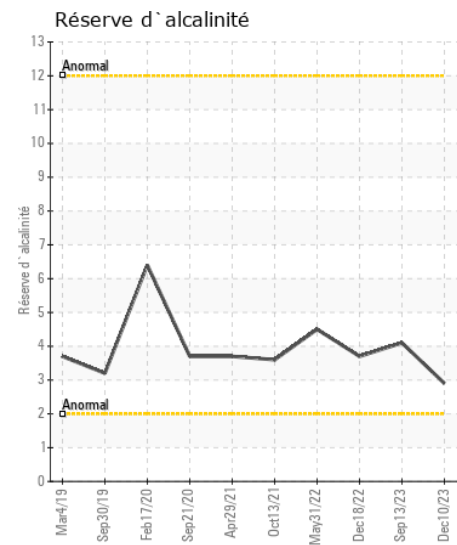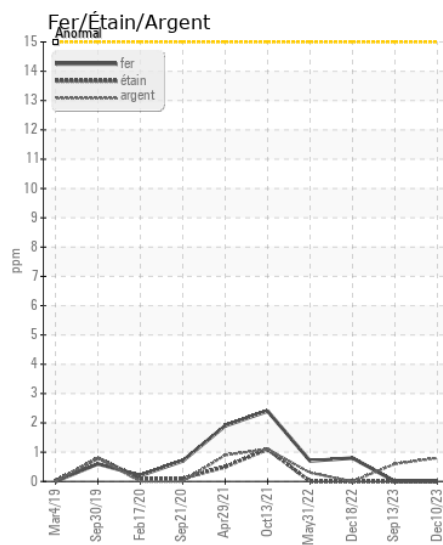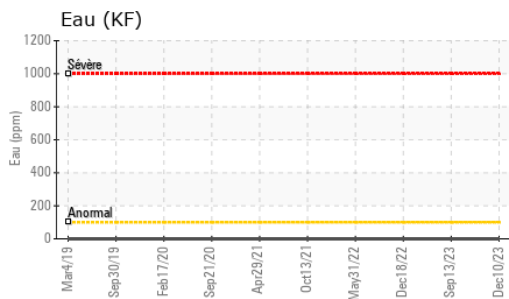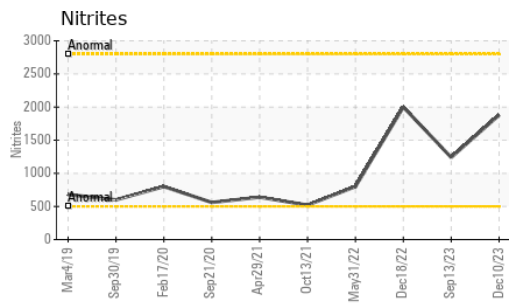

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.
N° d'échantillon : PC0078438 **Reçu** : 13 Dec 2023
N° de laboratoire : 02602943 **Diagnostiqué** : 18 Dec 2023
Numéro unique : 5696028 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : COOL (Additional Tests: KF)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

270 RUE BRUNET
MONT ST-HILAIRE, QC
CA J3H 0M6
Contact: Martin Trudel
mtrudel@michaudville.com

T:
F: