



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

1252
Composant
Transmission (Auto)
Fluid
DEXRON III (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0084188	PC0076040	PC0082231
Date d'échant.		Client Info		17 Jun 2024	17 Dec 2023	17 Oct 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		7147	6568	6102
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	SEVERE	NORMAL

USURE

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	22	49	131
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	8	20	52
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	3	9	21
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	4	16	50
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	2	6
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	<1
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	>10	4	6	7












CONTAMINATION

There is no indication of any contamination in the fluid.

Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		114	104	41
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		2	2	<1
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML

ÉTAT DU FLUIDE

L'eau		WC Method	>0.1	NEG	NEG	NEG
-------	--	-----------	------	------------	-----	-----

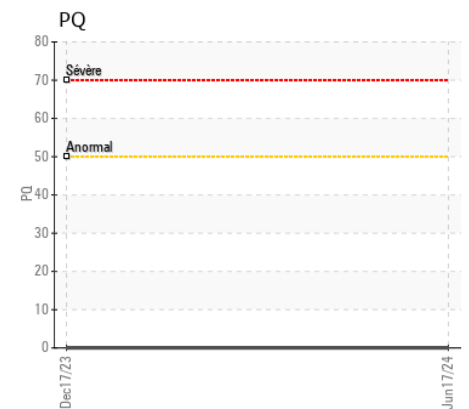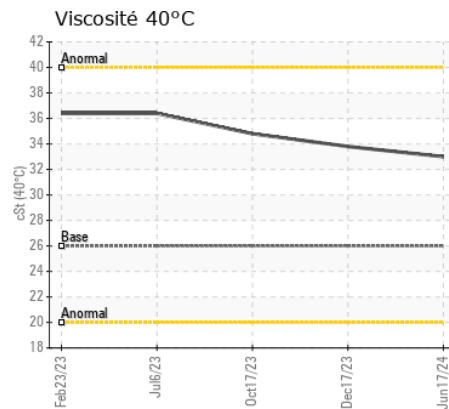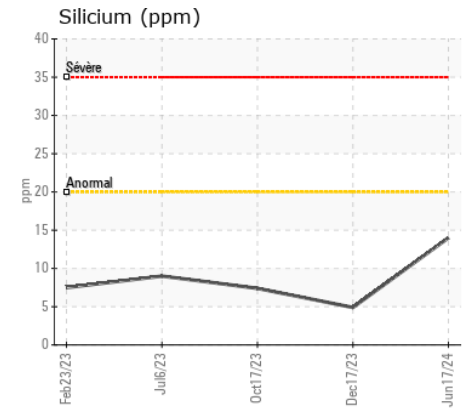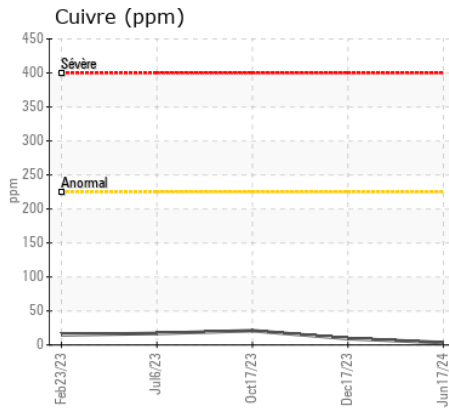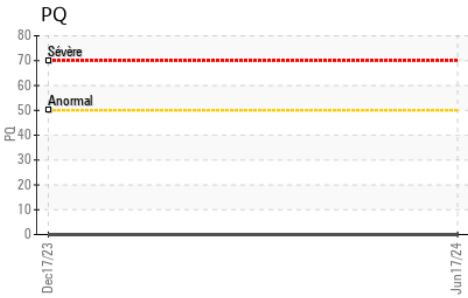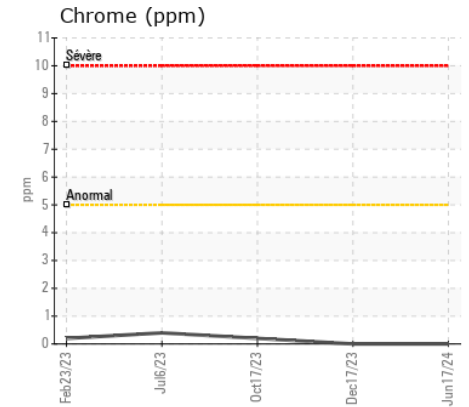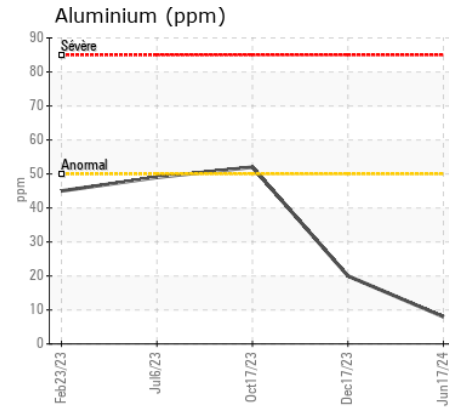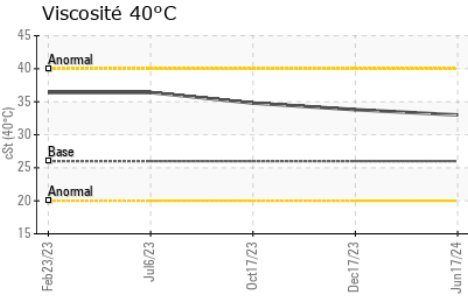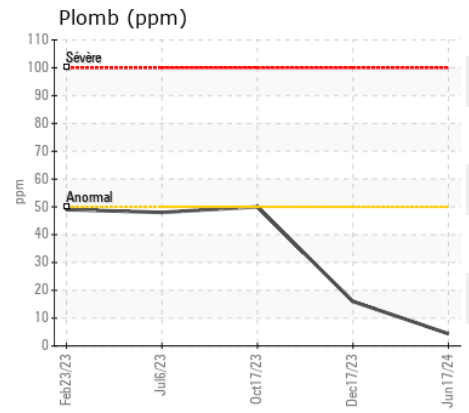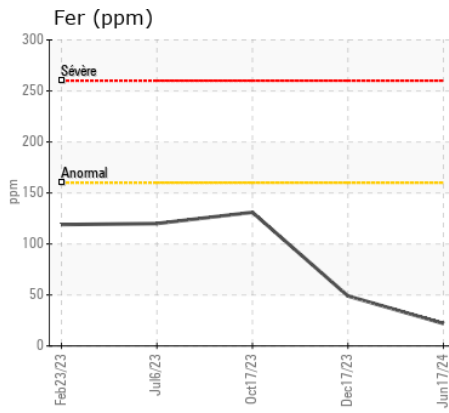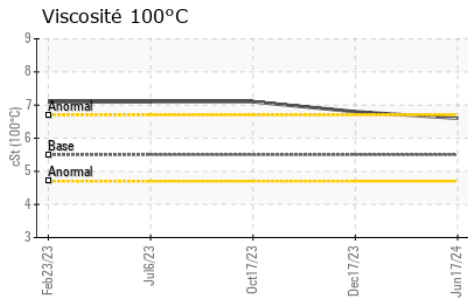

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.**
N° d'échantillon : PC0084188 **Reçu** : 18 Jun 2024 270 RUE BRUNET
N° de laboratoire : 02642711 **Tested** : 20 Jun 2024 MONT ST-HILAIRE, QC
Numéro unique : 5800250 **Diagnostiqué** : 20 Jun 2024 - Kevin Marson CA J3H 0M6
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: BoilingPoint, Cool, Hardness, ICP, KV100, KV40, PQ, Spat, VI, Vis) **Contact**: Martin Trudel
 mtrudel@michaudville.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F:

Cette page est intentionnellement laissée blanche